

Dräger Alcotest® 5000 Алкотестер

Dräger Alcotest® 5000 — это устройство для бесконтактного скрининга на алкоголь в выдыхаемом воздухе. Надежный и быстрый он позволяет производить до 12 проверок в минуту. Специальный мундштук-воронка уменьшает обратный поток выдыхаемого воздуха до минимума, предотвращая риск заражения для последующих испытуемых.



Преимущества

Быстрые и точные результаты измерений

Dräger Alcotest® 5000 позволяет производить до 12 проверок в минуту. Для полиции и служб безопасности компаний проверка на наличие паров этанола у большого количества людей за короткое время — это серьезная проблема: например, во время крупномасштабных операций, проверок при входе на производство, стадионы и в общественный транспорт или аэропортах. В случае положительного результата теста, при необходимости, могут быть определены точные уровни паров алкоголя с помощью профессиональных алкотестеров Dräger.

Точное экспресс-тестирование на алкоголь с использованием гигиенической воронки

При проведении теста на алкоголь механический контакт с испытуемым не требуется. Нет необходимости прикреплять и отсоединять мундштуки, поскольку для тестирования достаточно, чтобы испытуемые просто дули в мундштук-воронку. Конструкция воронки Dräger Alcotest 5000 предотвращает обратный поток воздуха, выдыхаемого испытуемым, и вдыхание любых патогенных микроорганизмов, источником которых могут быть предыдущие испытуемые. После использования она легко заменяется, гарантируя гигиеничность тестирования.

Простое тестирование на алкоголь

Alcotest 5000 управляется одной кнопкой «OK» и относится к поколению современных и простых в эксплуатации устройств Dräger для тестирования на алкоголь. Используя навигационные кнопки можно просматривать результаты последних тестов, сбрасывать счетчик тестов, проверять следующую запланированную дату калибровки, изменять язык меню и т.д. Подсказки в виде символов не зависят от языка и легко понятны.

Дистанционное тестирование дыхания на алкоголь

К Alcotest 5000 можно прикрепить телескопическую ручку и использовать прибор, когда лицо, проводящее тестирование, и испытуемый находятся на разной высоте, например, водитель сидит в кабине грузовика, что позволяет ускорить процесс тестирования.

Один комплект батареек позволяет выполнить с помощью Alcotest 5000 более 5000 тестов в различных режимах: в активном (испытуемый дует в воронку) и/или в пассивном (измерение паров этанола в окружающем ищевоздухе, в напитках при подозрении на его присутствие и пр.).

Многолетний опыт

Имея более чем 65-летний опыт работы, Dräger является мировым лидером в области тестирования алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полиция многих стран использует устройства серии Alcotest для повседневного мониторинга дорожного движения. Alcotest 5000 сделан в Германии и соответствует высочайшим стандартам качества. В нем используются электрохимические сенсоры, обеспечивающие точные и надежные результаты тестов.

Подробная информация



Резьба для крепления телескопической ручки




Комплект отражающей пленки: желтой или оранжевой (опция)



Ремешки на запястье



Символ «Идет процесс измерения»

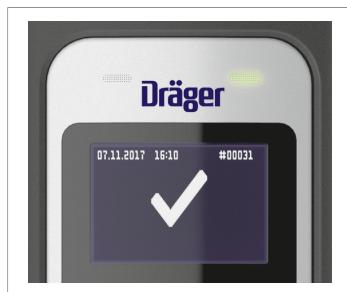


Символ «Алкоголь не обнаружен»



Символ «Алкоголь обнаружен»

Воронка Alcotest® 5000

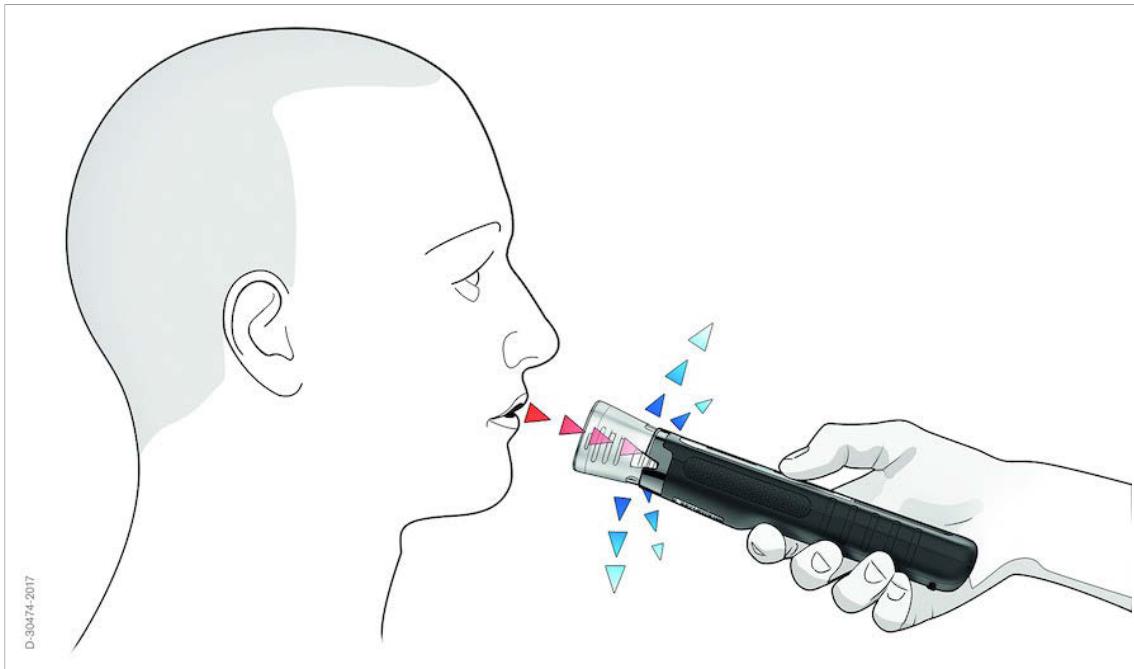

Специальный мундштук-воронка уменьшает обратный поток выдыхаемого воздуха, направленный на лицо испытуемого. Это гигиеническое новшество снижает риск взаимного заражения испытуемых.

Принадлежности



Мундштук-воронка Alcotest® 5000

Упаковка: 10 шт., гигиенически и индивидуально упакованные со специальными отверстиями, обеспечивающими минимизацию обратного потока выдыхаемого воздуха

Принадлежности



Комплект отражающей пленки Alcotest® 5000

Жёлтая или оранжевая (опция)



Адаптер для калибровки Alcotest® 5000

Калибровочное устройство для настройки Alcotest® 5000.



Питание

Щелочная батарея (Mignon, LR6, AA, 1,5 В)

Однородные продукты



Dräger Alcotest® 5820

Dräger Alcotest® 5820 позволяет специалисту быстро и точно выполнять тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Технология измерений, применяемая в этом компактном и удобном портативном измерительном приборе, уже проверена более чем на 200 тысячах устройств по всему миру.



Dräger Alcotest® 6820

Обеспечение безопасности на дорогах и отсутствие нетрезвых водителей на них – непредсказуемая и напряженная работа. Компания Dräger разработала ручной алкотестер Alcotest® 6820 специально для нужд сотрудников полиции. Он прост в использовании и быстро выдает надежные показания в сложнейших условиях, когда на счету каждая секунда.



Dräger Alcotest® 7510

Dräger Alcotest® 7510 – это компактный и надежный ручной прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это устройство идеально подходит для правоохранительных органов, а также для коммерческого или промышленного сектора. Во многих странах Alcotest® 7510 может использоваться в качестве доказательственного прибора.



Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 – новый формат приборов для измерений концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, имеющих доказательную силу. Он разработан в соответствии с национальными и международными нормативами (OIML R 126). Alcotest® 9510 с двойным датчиком имеет интуитивно понятный интерфейс, цветной сенсорный экран и современный дизайн.

Однородные продукты



D-42702-2015

Dräger DrugCheck 3000

Тест на наркотики Dräger DrugCheck 3000 за несколько минут определит, принимал ли человек наркотики. Компактный и быстрый, он позволяет получить достоверные результаты на основе анализа слюны. Комплект для неинвазивной проверки на наркотики не требует электропитания и поэтому может применяться где угодно.



D-54702-2012

Dräger DrugTest® 5000

Простой отбор, отсутствие контакта с образцом и малое время ожидания: никогда прежде тест на наркотические вещества не совершался так быстро и просто, как с Dräger DrugTest® 5000. Гарантия достоверности результата - автоматический анализ на месте сразу после отбора пробы.

Технические характеристики

Dräger Alcotest® 5000

Диапазон показаний	0 – 0,029 мг/л → Символ «Галочка» на экране дисплея означает «Алкоголь не обнаружен», визуально поддерживается зеленым светодиодом.
Отбор проб	От 0,030 мг/л → Символ «Х» на экране дисплея означает «Алкоголь обнаружен», визуально поддерживается красным светодиодом. От 2,5 мг/л → Превышение измерительного диапазона (↑↑↑) Автоматический отбор пробы при достижении минимального объема. Возможен пассивный режим отбора пробы без мундштука или ручная инициализация отбора.
Готовность к работе	< 4 секунд
Вывод результатов теста	Прибл. через 2 с (в диапазоне от 0 до 0,029 мг/л); Прибл. через 6 сек (например, при 0,5 мг/л при комнатной температуре).
Принцип измерения	Электрохимический сенсор, селективный на алкоголь DrägerSensor®
Дисплей	Графический ЖК-дисплей с подсветкой 32 x 22 мм (128 x 64 пикселей)
Светодиоды	Двухцветный, дополняет экран и предупреждающие сообщения
Звуковые сигналы	Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые сообщения и предупреждения
Регистрация данных	Хранение результатов 500 последних измерений с номерами тестов, датой и временем
Электропитание	3 батарейки типа АА, рассчитаны на 5000 измерений; зарядка батареи показана на дисплее.
Крепление мундштука	Защелкивающийся адаптер
Мундштук-воронка	Гигиенически и индивидуально упакованные со специальными отверстиями, обеспечивающими минимизацию обратного потока выдыхаемого воздуха
Управление	Подтверждение операций нажатием кнопки «OK»; для навигации по меню используются две кнопки со стрелками.
Калибровка	Калибровка влажным или сухим газом
Корпус	Ударопрочный АБС/Поликарбонат
Размеры (Д x Ш x В), вес	прибл. 63 x 219 x 41 мм; около 245 г с мундштуком-воронкой и батареей
Сертификаты	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
Маркировка EC	Директива по ЭМС
Стандарты	В настоящее время отсутствуют какие-либо стандарты, распространяющиеся на бесконтактные устройства для обнаружения алкоголя в выдыхаемом воздухе
Встроенные часы	Предупреждение за 30 дней до наступления срока обслуживания
Рекомендуемый срок калибровки	24 месяца

Технические характеристики

Рабочая температура	-15...+50 °C
Относительная влажность	10 – 100 %
Давление	(без конденсации, в рабочем режиме) 60 – 130 кПа

Спецификация заказа

Dräger Alcotest® 5000, V1

Языки: английский, немецкий, французский, испанский, нидерландский, итальянский, каталанский, португальский

Dräger Alcotest® 5000, V2

Языки: английский, польский, финский, шведский, датский, норвежский, эстонский, литовский, латышский

Dräger Alcotest® 5000, V3

Языки: английский, русский, украинский, словацкий, словенский, чешский, венгерский, боснийский, хорватский

Dräger Alcotest® 5000, V4

Языки: английский, греческий, турецкий, болгарский, румынский, сербский, хинди, иврит, арабский

Dräger Alcotest® 5000, V5

Языки: английский, японский, корейский, китайский, китайский (Гонконг)

Dräger Alcotest® 5000, V6

Языки: английский, китайский (Тайвань), малайский, тайский, вьетнамский

Воронки Alcotest® 5000, 10 шт., индивидуально и гигиенически упакованные

Комплект отражающей пленки (желтой), Alcotest® 5000

Комплект отражающей пленки (оранжевой), Alcotest® 5000

Щелочные батарейки (Mignon, LR6, AA, 1,5V) — требуется 3 батарейки

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
[www.draeger.com](http://www draeger com)

Официальный дистрибутор Drägerwerk AG & Co. KGaA на территории Казахстан
ТОО «Компания ECOS»
Офис и сервисный центр в г.Алматы 050057, РК, г.Алматы, ул.Жарокова, д.210А
www.ecos.kz

По вопросам поставок приборов Alcotest: Кругова Ирина
менеджер по продажам
Email: irina.krugova@ecos.kz
Тел. Сл.: +7 (727)/356 13 34; 356 33 56 (вн.604)

По вопросам поставок оборудования, инжиниринга, проектирования sales@ecos.kz
По вопросам сервисного обслуживания services@ecos.kz